

无柱式人NK细胞分选试剂盒（阴选）

[组分]

产品名称	产品货号	产品规格	产品成分
无柱式人 NK 细胞分选试剂盒（阴选） NK（Human） Cell Isolation Kit	51-01-0023-S	10 test (分选 1×10^8 个细胞总量)	1 瓶 200 uL 人 NK 细胞混合抗体、 1 瓶 200 uL 链霉亲和素磁珠
	51-01-0023-M	50 test (分选 5×10^8 个细胞总量)	1 瓶 1 mL 人 NK 细胞混合抗体、 1 瓶 1 mL 链霉亲和素磁珠
	51-01-0023-L	100 test (分选 1×10^9 个细胞总量)	1 瓶 2 mL 人 NK 细胞混合抗体、 1 瓶 2 mL 链霉亲和素磁珠

[储存条件] 2 - 8 °C 避光保存，请勿冷冻。有效期 12 个月。

[试剂和仪器要求]

- 缓冲液：配制含有 pH 7.2 PBS、0.5% 牛血清白蛋白（BSA）和 2 mM EDTA 的溶液。
- 分选磁极

[产品操作步骤]

一、样本准备


人血样本（新鲜样本）处理时，使用密度梯度离心制备 PBMC 细胞悬液，制备完成的细胞悬液保存在 2-8°C 中。

二、细胞分离步骤

1. PBMC 细胞浓度调整为 1×10^8 cells/mL，5mL 流式管中加入要分选的细胞悬液（注：单管中细胞加入量最多为 1×10^8 cells/mL）。
2. 以 200uL 抗体/mL PBMC 细胞的比例将人 NK 混合抗体加入细胞悬液中，用移液枪轻柔吹打或涡旋震荡 5S，充分混合后室温孵育 5min。
3. 抗体孵育完成后，以 200uL 链霉亲和素磁珠/mL PBMC 细胞的比例将链霉亲和素磁珠加入步骤 2 的细胞悬液中，用移液枪轻柔吹打或涡旋震荡 5S，充分混合后室温孵育 2min（注：磁珠使用之前请涡旋振荡或吹打混匀）。
4. 磁珠孵育完成后，加入适量的分选缓冲液，将流式管中的细胞悬液配至 2.5mL 体系。
5. 将带有细胞悬液的流式管放入磁极中，磁吸附 3min（注：液体完全在磁极磁场范围内）。
6. 握住磁极将未结合磁珠的目的细胞倾倒入新的离心管中，即为未标记的富集得到的人 NK 细胞（注：最后一滴液体不要倾倒出来，对目的细胞纯度有影响）。

[分选效果]

从人 PBMC 中分选 NK 细胞，分选前后的细胞用 FITC anti-human CD3、PE anti-human CD56 标记后进行流式分析，分选前后的 NK 细胞纯度分别为 9.60%和 90.59%。

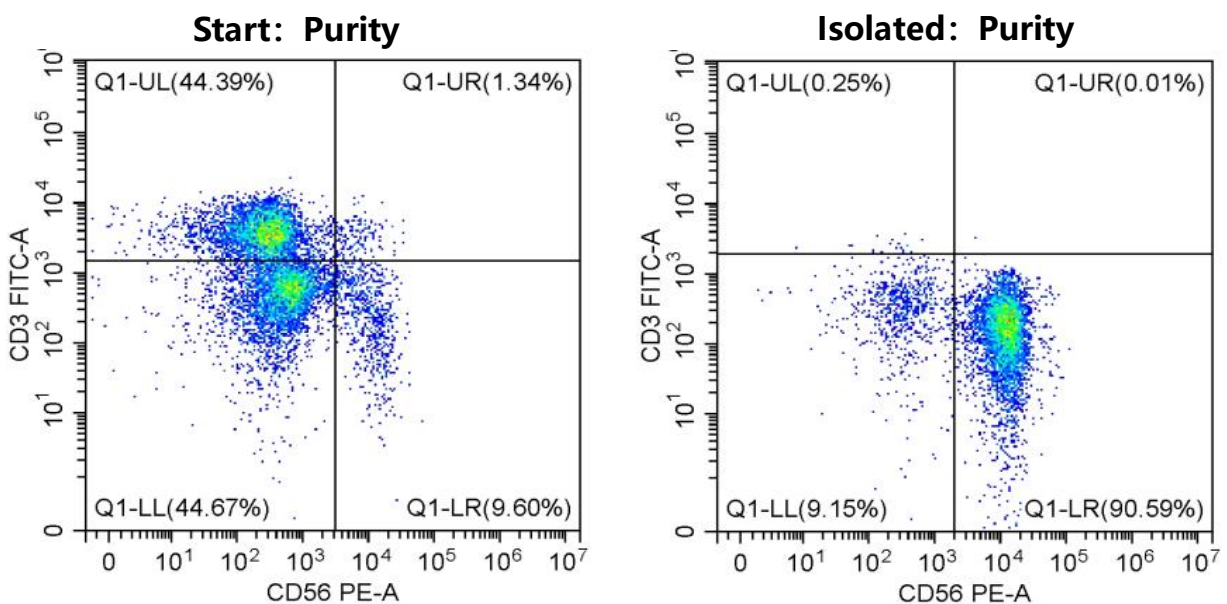

[注意事项]

- 1.细胞孵育温度为室温，高温或延长孵育时间可能导致细胞非特异性结合。
- 2.本产品保质期为 12 个月，产品过期后性能下降，不建议使用。